

# 包装変更のお知らせ

気管支拡張剤

## ベロテック®シロップ0.05%

平成30年2月

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、「**ベロテック®シロップ0.05%**」におきまして、包装仕様の変更を致しますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、製剤、各種コードに変更はございません。

今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


### 変更内容

①ラベルの製造番号・使用期限の刻印方法を変更致します。


変更前




変更後

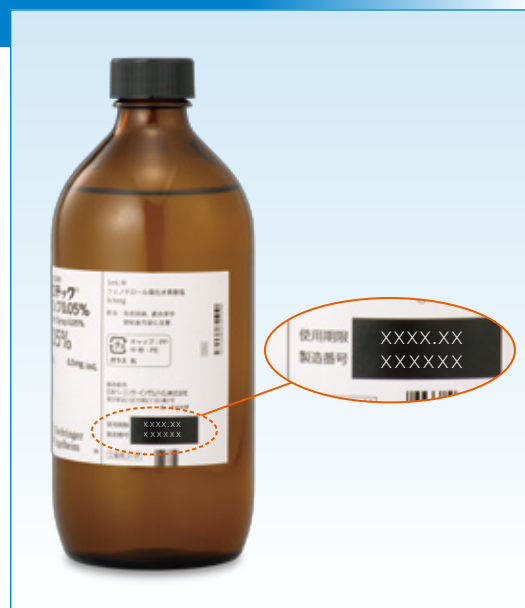

- ②個装箱の開封部の表示を追加致します。
- ③個装箱に「包装変更品」の表示を致します。

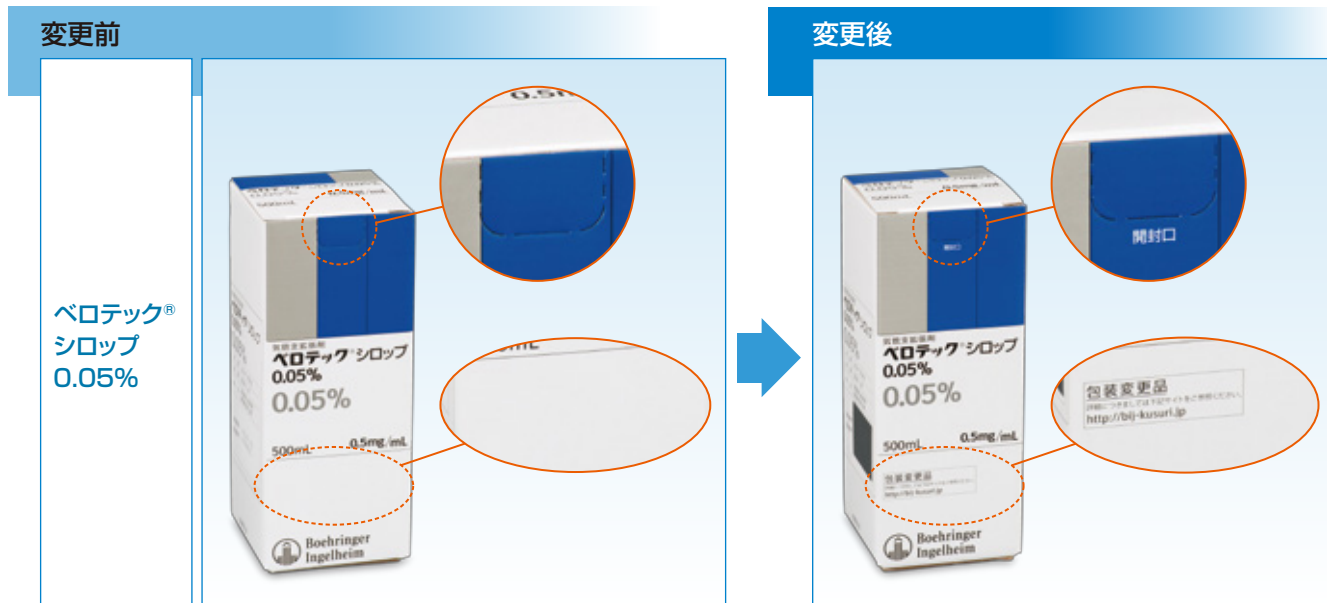

- ④個装箱の製造番号・使用期限の刻印方法を変更致します。

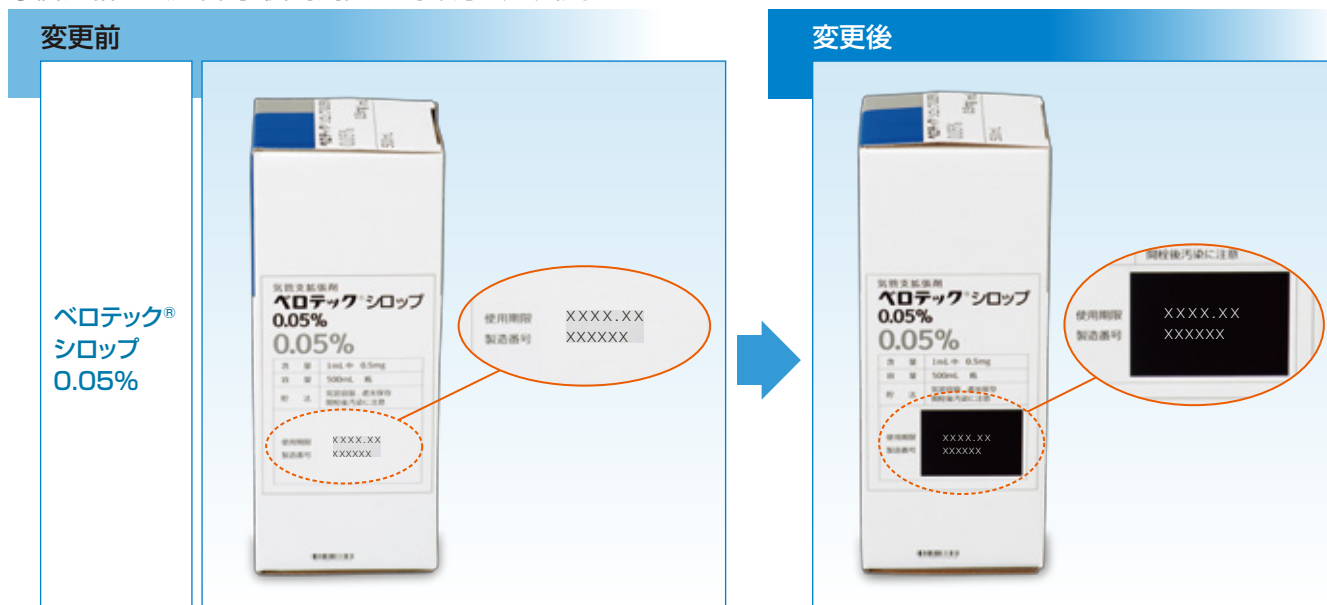

### ■変更品の出荷予定時期

品名	包装単位	統一商品コード	変更前 最終製造番号	変更後 初回製造番号	出荷時期* (予定)	販売包装単位コード
						調剤包装単位コード
ペロテック® シロップ 0.05%	500mL 瓶	413152136	679001	779001	2018年3月上旬	

\*在庫状況により変更品がお手元に届く時期が若干前後することがありますが、ご容赦賜りますようお願いいたします。

以上

【お問い合わせ先】  
 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社  
 DIセンター : 0120-189-779  
 [受付時間] 9:00~18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)